



16.05.2019		מתאריך:		רפואה		שם אגף/מרחב:	
עמודים		1 מתוך 1		בטיחות הטיפול		נושא:	


**כמעט ונפגע - מתן שוק ללא הקפדה על כללי הבטיחות**

חובשים ופרמדיקים שלום רב, בעת האחרונה היה אירוע בו ניתן שוק למטופל במהלך החייאה ללא הקפדה על כללי הבטיחות הבסיסיים:

**השתלשלות האירוע:**

1. צוות אט"ן נשלח לאירוע של דום לב.
2. בהגעת הצוות למקום - צוות BLS במקום מבצע פעולות החייאה על המטופל במטבח, דפיברילטור חצי אוטומטי מסוג לייפק CR2 מחובר.
3. היות וחלל המטבח היה קטן מדי, הפראמדיק ביקש להעביר את המטופל לאזור מרווח יותר.
4. אנשי הצוות הרימו את המטופל והחלו להעבירו לחדר השני.
5. במהלך ההעברה הדפיברילטור התריע שמומלץ שוק והחל לטעון.
6. הפראמדיק, שכבר היה בחדר השני אמר - "צריך לתת שוק".
7. אחד ממתנדבי הנוער שהיה במטבח לחץ על כפתור הדפיברילציה ונתן שוק בזמן שהמטופל מוחזק ע"י שני אנשי הצוות האחרים.

**פלט נתוני הדפיברילטור:**

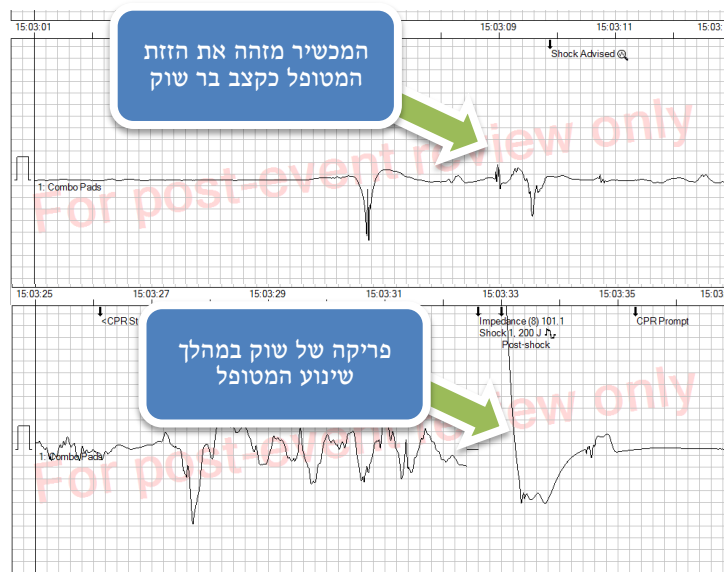

**לקחים:**

1. אירוע זה מדגיש את חשיבות העבודה ע"פ כללי הבטיחות הבסיסיים – במהלך החייאה, במידה והדפיברילטור ממליץ על שוק יש לוודא שאיש אינו נוגע במטופל, במדבקות, או בכל חומר/נוזל אחר הנוגע במטופל.
2. בעת חיבור מד' הדפיברילציה למטופל חשוב להצמידן היטב לגופו של המטופל ולמנוע מגע שלהן בחומרים אחרים - הדבר עלול להוביל לניצוצות חשמליים, כוויות בעור ולהסטה של אנרגיית הדפיברילציה מהלב.
3. מכשירי לייפק CR2 מצוידים בתוכנה שמזהה קצב בר שוק במהלך החייאה, הזנת המטופל גרמה לאבחון שגוי של קצב ליבו של המטופל ולהמלצה על שוק למרות שבפועל המטופל היה באסיסטולה.

בברכה,  
תומר קפלן  
מפקח אגף רפואה